

OBJETO I: MÁQUINA UNITARIZADORA DE MEDICAMENTO 1 unidade

Resultado de Seleção nº 0001/2019 – parte II

Referente ao processo de Seleção nº 0001/2019 – Aquisição de Máquina unitarizadora de medicamento, após a análise criteriosa das instâncias competentes, registre-se o seguinte:

Item: MÁQUINA UNITARIZADORA DE MEDICAMENTO

Quantidade: 1 (uma) unidade

Primeiro menor valor unitário cotado: R\$ 81.200,00

Fornecedor: Sisnac Produtos para Saúde Ltda

Segundo menor valor unitário cotado: R\$ 110.000,00


Fornecedor: Opuspac Indústria e comércio de máquinas Ltda EPP

Terceiro menor valor unitário cotado: R\$ 155.000,00


Fornecedor: Mea Modul Ltda EPP

Após visita técnica realizada *in loco*, na data de 05 de junho de 2019, considerando as ponderações exaradas na Declaração Técnica de não Conformidade anexa, a Comissão Permanente de Licitação da Associação Mário Penna decide pela desclassificação do fornecedor Opuspac Indústria e comércio de máquinas Ltda EPP. Nesse sentido, solicita que no prazo de 15 (quinze) dias da presente publicação, o terceiro fornecedor, qual seja, Mea Modul Ltda EPP, faça a demonstração ou promova a visita *in loco* para análise técnica do equipamento licitado. A demonstração deverá ser agendada através do telefone (31) 3299-9920 ou 3299-9919.


Belo Horizonte, 17 de junho de 2019.




Heleno Oliveira Silvestre
Coordenador de Suprimentos
Instituto Mário Penna

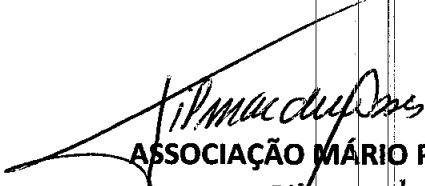

ASSOCIAÇÃO MÁRIO PENNA
Gilmar de Assis
Presidente
Instituto Mário Penna



Vitor de Melo Franco
OAB/MG 118.126
Instituto Mário Penna



Tatiane Pereira Canedo
OAB/MG 133.192
Instituto Mário Penna

DECLARAÇÃO TÉCNICA DE NÃO CONFORMIDADE DE EQUIPAMENTOS

Declaro para os devidos fins que o equipamento máquina unitarizadora de medicamento, do fornecedor Opuspac Indústria e comércio de máquinas Ltda EPP, **não** atende a todos os requisitos da especificação técnica do Plano de trabalho referente ao convênio 848452/2017, edital 001/2019.


Cumprir informar que a Equipe Técnica institucional foi verificar *in loco* o equipamento, na data de 05 de junho de 2019, constatando não conformidades relatadas no documento anexo, parte integrante e vinculante à presente Declaração de não Conformidade.

Ainda, cabe ressaltar que a avaliação técnica por tópicos foi realizada no equipamento Opus Ink, ou seja, equipamento diverso/similar ao declarado vencedor. Infelizmente o fornecedor Opuspac Indústria e comércio de máquinas Ltda EPP apresentou somente uma promessa de entrega do equipamento licitado, não podendo esta ser avaliada tecnicamente, o que ocasiona sua não conformidade técnica.

Belo Horizonte, 13 de junho de 2019.


Italo Antônio Batista Esteves
Técnico de Eletrônica III

Manutenção de Equipamentos Biomédicos da Associação Mário Penna


Jomar Paulino
Coordenador de Suprimentos
Associação Mário Penna

Registro da visita técnica para validação do Termo de detalhamento técnico para a compra de Máquina Unitarizadora De Medicamentos

ITEM		OBSERVAÇÃO POR TÓPICO
Descrição Geral:		
Equipamento utilizado para identificação e rastreabilidade dos Materiais Médicos e Medicamentos		Não atendeu para ampolas inferior a 3 ML. Apresentou dificuldade na unitarização de equipamentos (envelopes tipo grau cirúrgico) o mesmo não se desloca adequadamente na esteira o que poderá acarretar atraso no processo.
<u>Características gerais:</u>		
Sistema automático para identificação e rastreabilidade de todos os materiais médicos e medicamentos com código data matrix, permitindo checagens eletrônicas, e interface eletrônica com os softwares de gestão da Instituição		Não apresentou bom desempenho na identificação de todos os produtos.
<u>Requisitos técnicos:</u>		
Impressão data matrix direto na forma farmacêutica		
Utilizar diversas formas farmacêuticas: ampolas, frascos-ampolas, frascos, seringas, agulhas, gazes, sachês, invólucros, bolsas e materiais		Equipamento apresentado não possui duas cabeças de impressão, não permitindo a identificação de ampolas âmbar (aplicação do fundo branco) e transparentes.
Equipamento em aço inoxidável, que possua dois suportes para bandeja, ligado à esteira e outro na mesa, facilitando o fluxo de saída dos medicamentos e materiais unitarizados		Não nos foi apresentado em aço inoxidável, e sim um equipamento similar em estrutura metálica pintada.
Botão liga/desliga, botão para controle de velocidade variável adaptando a velocidade de trabalho		Possui botão liga/desliga, mas não há botão para controle de velocidade, desta forma a velocidade de trabalho será única.
Possuir duas impressoras jatos de tintas, que deverão ser para o fundo de tinta branca e datamatrix com tinta preta		Equipamento apresentado não possui duas cabeças de impressão, ou seja não permite a impressão do fundo branco dificultando a identificação de ampolas âmbar e transparentes, por exemplo.
Possuir duas telas de touch screen para cadastro dos itens e armazenamento dos dados		Possui apenas uma tela touch.

Italo Antônio Batista Esteves
Técnico de Eletrônica III

Manutenção de Equipamentos Biomédicos da Associação Mário Penna

Jomar Paulino

Coordenador de Suprimentos

Associação Mário Penna